

Instrucciones de uso




PUR-Blue™ Dispositivo de muestreo de hisopos

Mire el video de demostración

<https://www.worldbioproducts.com/purblue-swabs.html>


US Patent 9,027,420

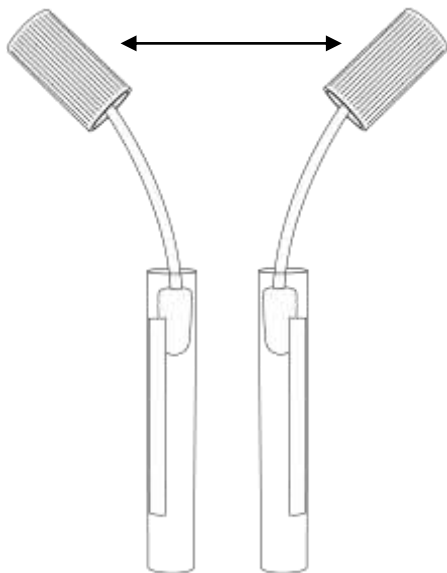


2. Desenrosque la tapa del tubo de hisopo. Presione cada lado de la punta del hisopo contra el interior del tubo para eliminar el exceso de medio.





1. Etiquetar el tubo.

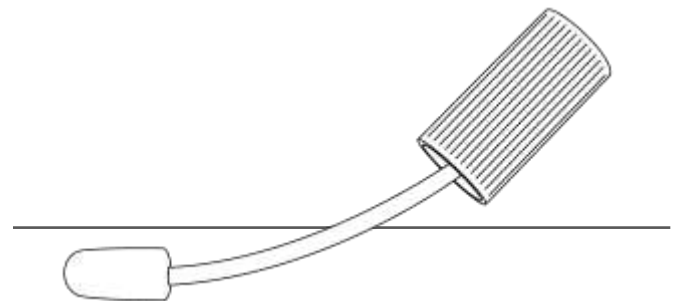


3. Presione firmemente contra la superficie para asegurarse de que la punta del hisopo haga contacto completo con la superficie de la muestra.

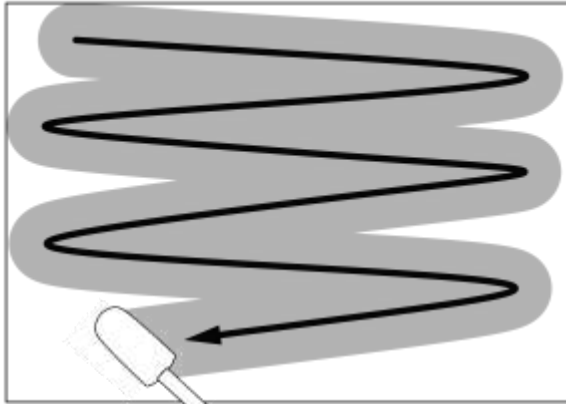

4. Frote vigorosamente hacia adelante y hacia atrás sobre la superficie, mientras gira el hisopo para asegurarse de que toda la punta del hisopo haga contacto con la superficie.

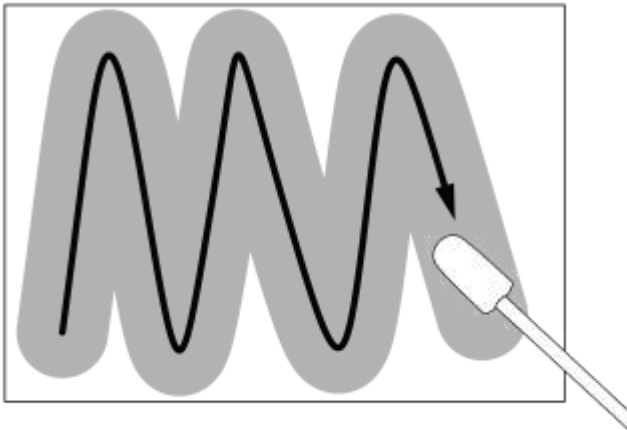

5. Cambie la dirección 90 ° y repita el proceso.



6. Vuelva a colocar el hisopo en el tubo y apriete la tapa. Enviado al laboratorio para su análisis.

Limitación de responsabilidad

World Bioproducts LLC no será responsable de ningún daño especial o consecuente que resulte del uso o la imposibilidad de uso de estos materiales o el rendimiento de los productos, incluso si se ha informado a World Bioproducts LLC de la posibilidad de dichos daños. La ley aplicable puede no permitir la limitación de la exclusión de responsabilidad o daños incidentales o consecuentes, por lo que la limitación o exclusión anterior puede no aplicarse a usted.

Para uso in vitro solamente

Hojas de datos de seguridad y certificados de análisis disponibles a petición

Consulte la etiqueta del paquete para obtener información de almacenamiento

World Bioproducts, LLC
Call +1-877-260-6441 / Mail PO Box 947, Bothell, WA 98041
Email orders@worldbioproducts.net / Visit worldbioproducts.com

